

Report

Sunshine C-Pulse Device = wie IABP nur von außen an der Aorta ascendens angebracht.


Fragestellung Thorax Röntgen:


Erguss, Stauung, Infiltrat, Pneu?

Befund Thorax Röntgen:

Zwerchfell beidseits scharf abgrenzbar. PC-Winkel frei. Trachea mittelständig. Hili und periphere Gefäßzeichnung scharf. Vergrößerter Schatten der Aorta ascendens bei aufgeblasenem C-Pulse Device. Kein pleuraler Aufhellungssaum. Degenerative BWS-Veränderungen bei Osteopenie.

ICD Aggregat links pectoral mit Projektion der Sondenspitze auf den rechten Ventrikel. Epimyokardiale Schrittmacherelektrode mit Projektion der Spitze auf den Apex und Ausführung nach kutan. Ausführung des Druckschlauches des C-Pulse links pectoral. Sternalcerclagen.

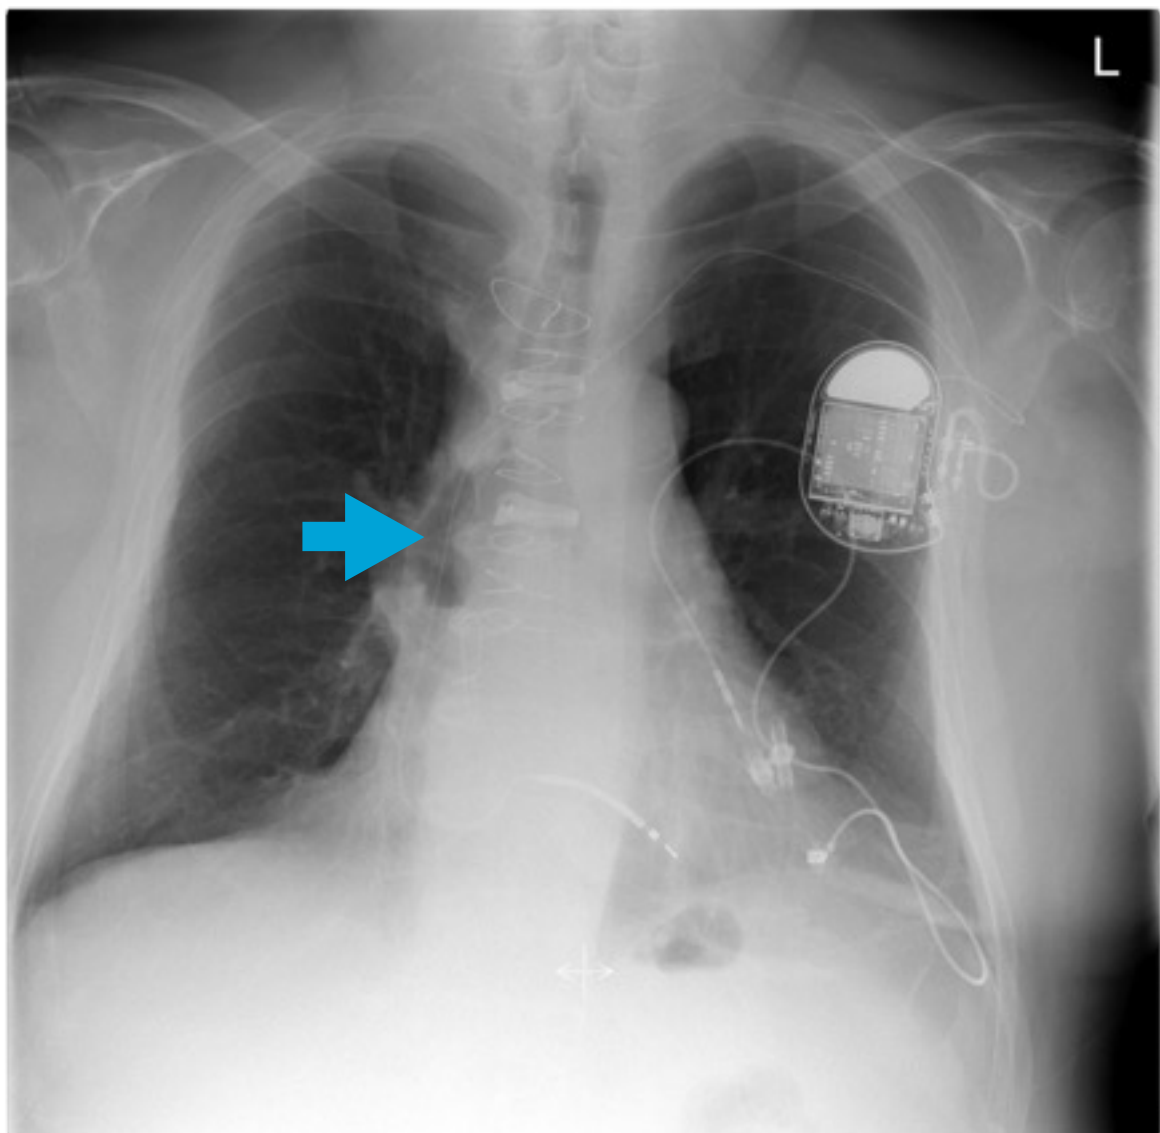

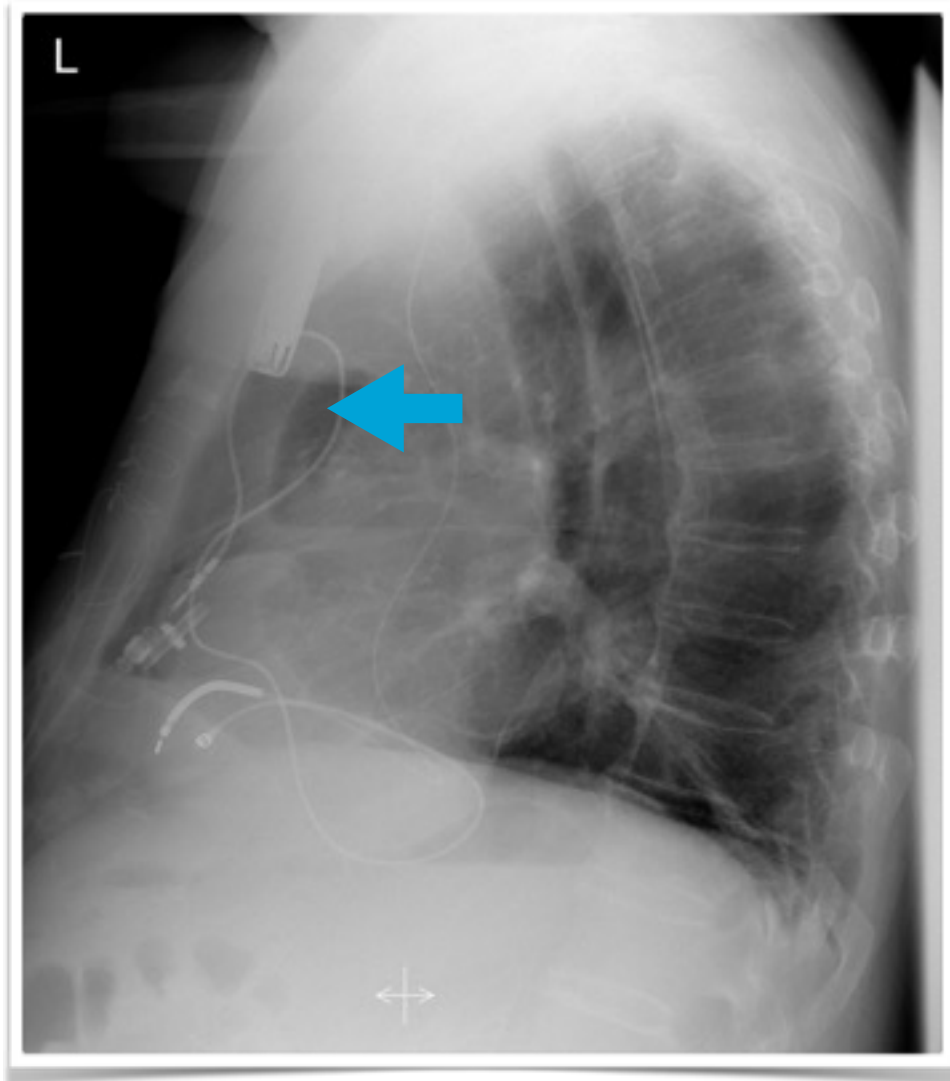

Befund Thorax CT:

Luft ventral der Aorta ascendens, dem eingebrachten Sunshine- Heart-Device entsprechend. Geringe Mengen Flüssigkeit am Device, DD postoperatives Hämatom.

Keine Aortendissektion. Fortgeschrittene Koronarsklerose und dilatative Kardiomyopathie.

